
SLH - R28col - 3

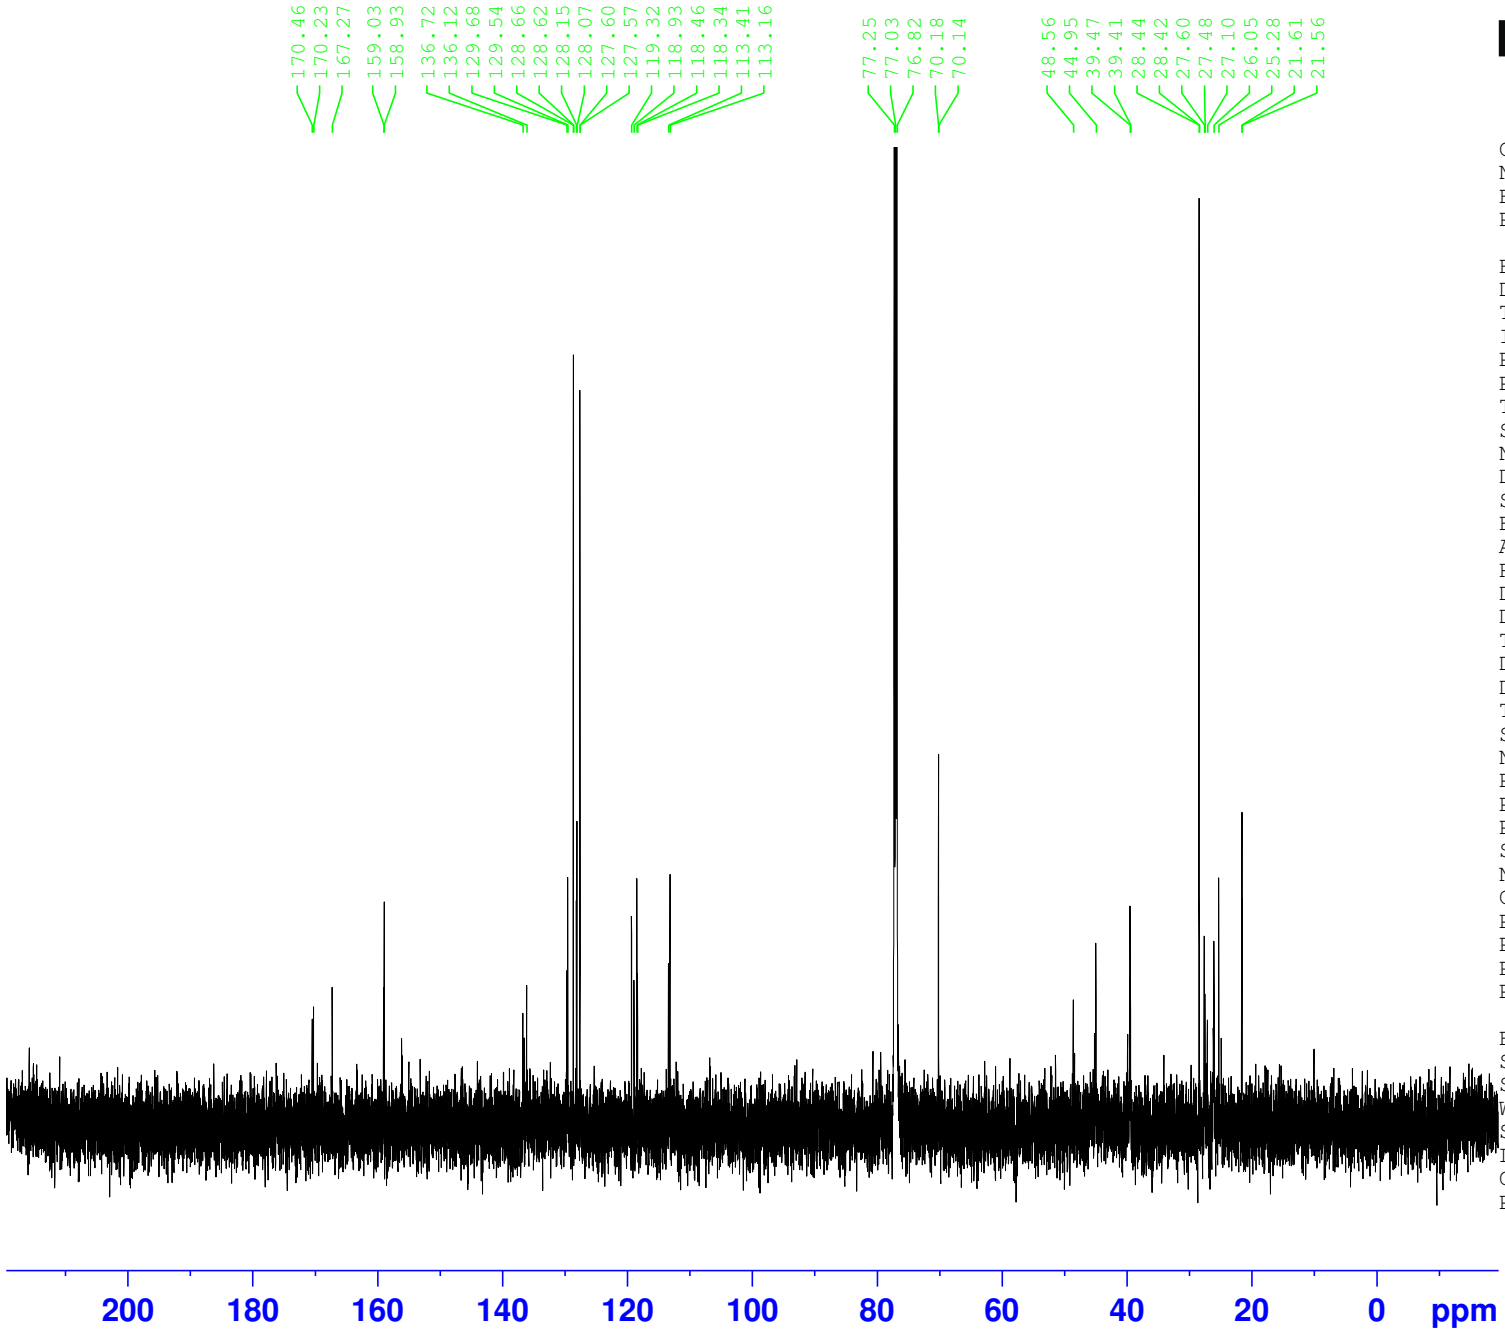

Current Data Parameters

NAME	Huegel
EXPNO	341
PROCNO	1

F2 - Acquisition Parameters

Date_	20241021
Time	22.43 h
INSTRUM	spect
PROBHD	Z114607_0045 (
PULPROG	zgpg30
TD	65536
SOLVENT	CDCl3
NS	1024
DS	4
SWH	36057.691 Hz
FIDRES	1.100393 Hz
AQ	0.9087659 sec
RG	2050
DW	13.867 usec
DE	6.50 usec
TE	297.9 K
D1	2.00000000 sec
D11	0.03000000 sec
TD0	1
SFO1	150.9178979 MHz
NUC1	13C
P0	3.13 usec
P1	9.40 usec
PLW1	134.89999390 W
SFO2	600.1324005 MHz
NUC2	1H
CPDPRG[2	waltz16
PCPD2	70.00 usec
PLW2	22.90900040 W
PLW12	0.58961999 W
PLW13	0.29657000 W

F2 - Processing parameters

SI	32768
SF	150.9028085 MHz
WDW	EM
SSB	0
LB	1.00 Hz
GB	0
PC	1.40