
SLH - R28col - 3

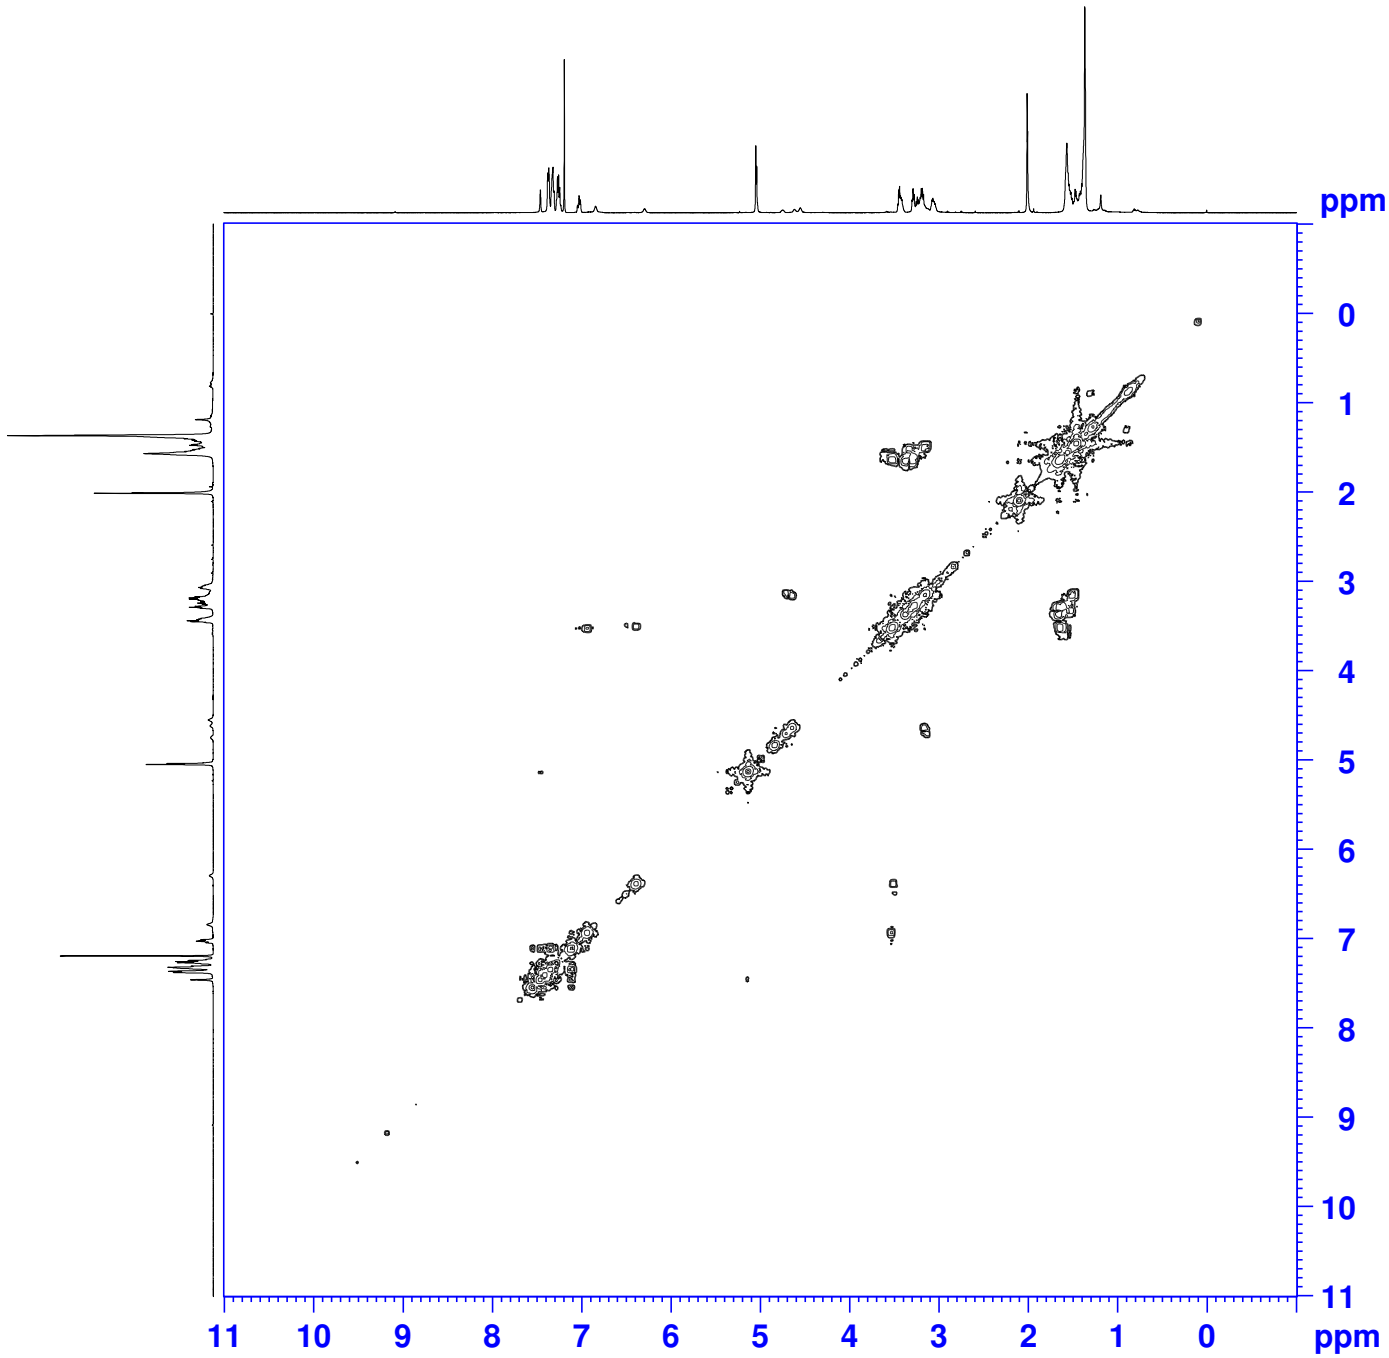

BRUKER

Current Data Parameters
NAME Huegel
EXPNO 342
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20241021
Time 23.40 h
INSTRUM spect
PROBHD Z114607_0045 (
PULPROG cosygpqf
TD 2048
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 8
SWH 7211.539 Hz
FIDRES 7.042518 Hz
AQ 0.1419947 sec
RG 406
DW 69.333 usec
DE 6.50 usec
TE 297.8 K
D0 0.00000300 sec
D1 1.48689198 sec
D13 0.00000400 sec
D16 0.00020000 sec
IN0 0.00013860 sec
TDav 1
SFO1 600.1330006 MHz
NUC1 1H
P0 11.23 usec
P1 11.23 usec
PLW1 22.90900040 W
GPNAM[1] SINE.100
GPZ1 10.00 %
P16 1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
TD 128
SFO1 600.133 MHz
FIDRES 112.734489 Hz
SW 12.022 ppm
FnMODE QF

F2 - Processing parameters
SI 1024
SF 600.1300000 MHz
WDW SINE
SSB 0
LB 0 Hz
GB 0
PC 1.40

F1 - Processing parameters
SI 1024
MC2 QF
SF 600.1300000 MHz
WDW SINE
SSB 0
LB 0 Hz
GB 0