
SLH - R40col

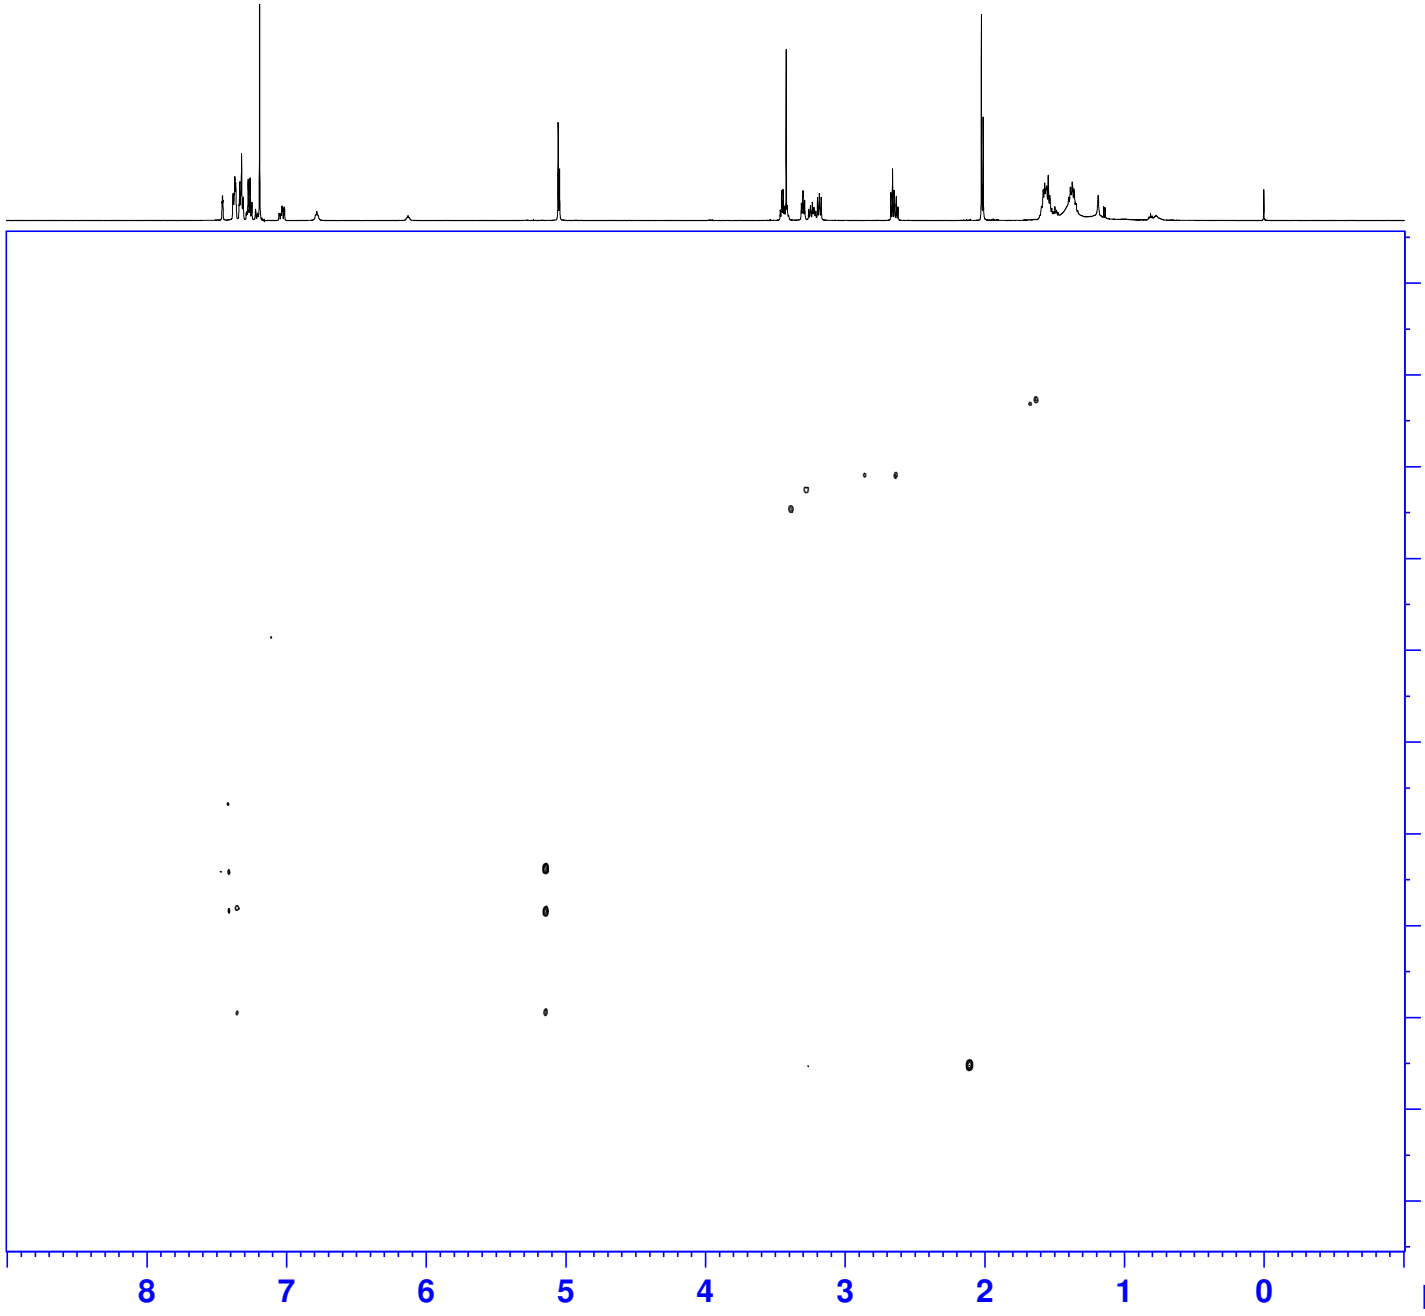

Current Data Parameters

NAME	Huegel
EXPNO	605
PROCNO	1

F2 - Acquisition Parameters

Date_	20241125
Time	19.06 h
INSTRUM	spect
PROBHD	Z114607_0045 (
PULPROG	hmbcgpndqf
TD	4096
SOLVENT	CDCl3
NS	8
DS	16
SWH	6009.615 Hz
FIDRES	2.934382 Hz
AQ	0.3407872 sec
RG	2050
DW	83.200 usec
DE	6.50 usec
TE	300.0 K
CNST13	8.0000000
D0	0.00000300 sec
D1	1.50000000 sec
D6	0.06250000 sec
D16	0.00020000 sec
IN0	0.00001490 sec
TDav	1
SFO1	600.1324005 MHz
NUC1	1H
P1	11.23 usec
P2	22.46 usec
PLW1	22.90900040 W
SFO2	150.9178739 MHz
NUC2	13C
P3	9.40 usec
PLW2	134.89999390 W
GPNAM[1]	SINE.100
GPZ1	50.00 %
GPNAM[2]	SINE.100
GPZ2	30.00 %
GPNAM[3]	SINE.100
GPZ3	40.10 %
P16	1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters

TD	128
SFO1	150.9179 MHz
FIDRES	524.328857 Hz
SW	222.353 ppm
FnMODE	QF

F2 - Processing parameters

SI	1024
SF	600.1300000 MHz
WDW	SINE
SSB	0
LB	0 Hz
GB	0
PC	1.40

F1 - Processing parameters

SI	1024
MC2	QF
SF	150.9028085 MHz
WDW	SINE
SSB	0
LB	0 Hz
GB	0