
OHA - 09 - F11-F18

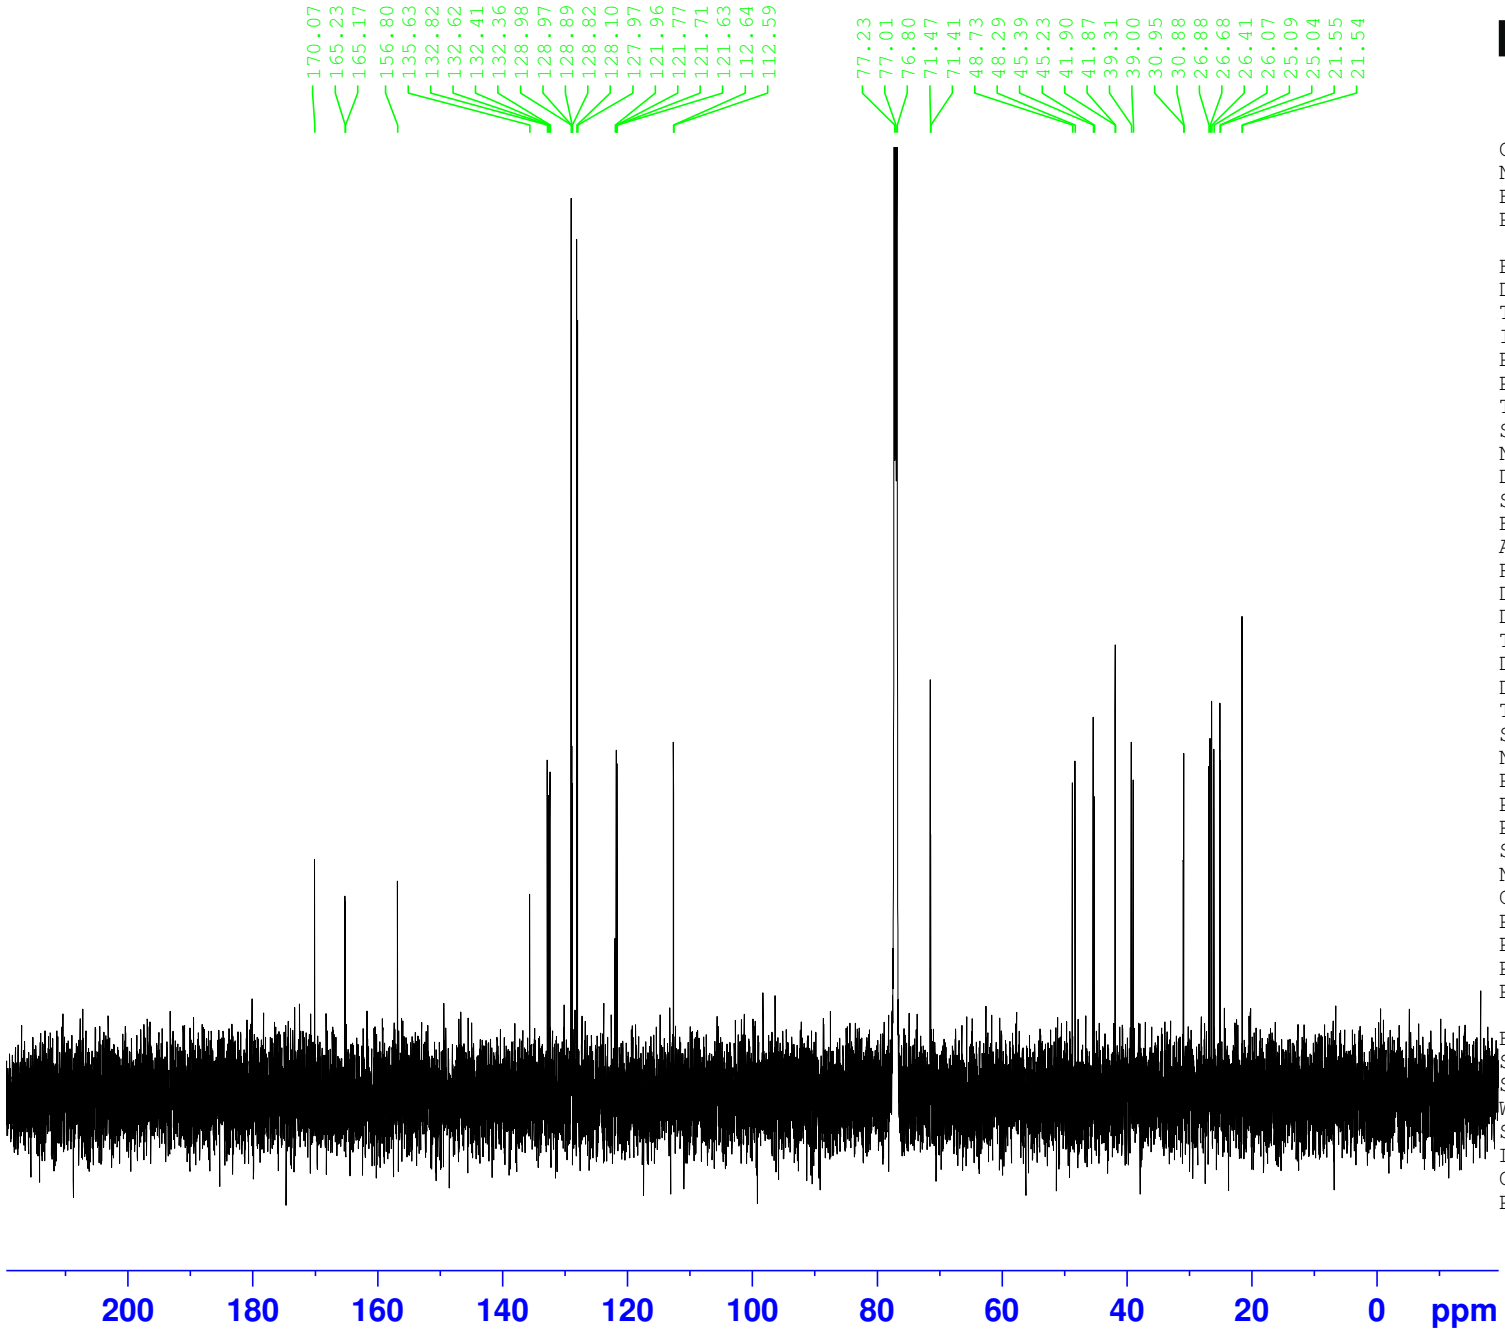

BRUKER

Current Data Parameters
NAME Mertens
EXPNO 901
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20250505
Time 20.49 h
INSTRUM spect
PROBHD Z114607_0045 (
PULPROG zgpg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 4096
DS 4
SWH 36057.691 Hz
FIDRES 1.100393 Hz
AQ 0.9087659 sec
RG 2050
DW 13.867 usec
DE 6.50 usec
TE 300.0 K
D1 2.00000000 sec
D11 0.03000000 sec
TD0 1
SFO1 150.9178979 MHz
NUC1 13C
P0 3.13 usec
P1 9.40 usec
PLW1 134.89999390 W
SFO2 600.1324005 MHz
NUC2 1H
CPDPRG[2 waltz16
PCPD2 70.00 usec
PLW2 22.90900040 W
PLW12 0.58961999 W
PLW13 0.29657000 W

F2 - Processing parameters
SI 32768
SF 150.9028085 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40