
OHA - 09 - F11-F18

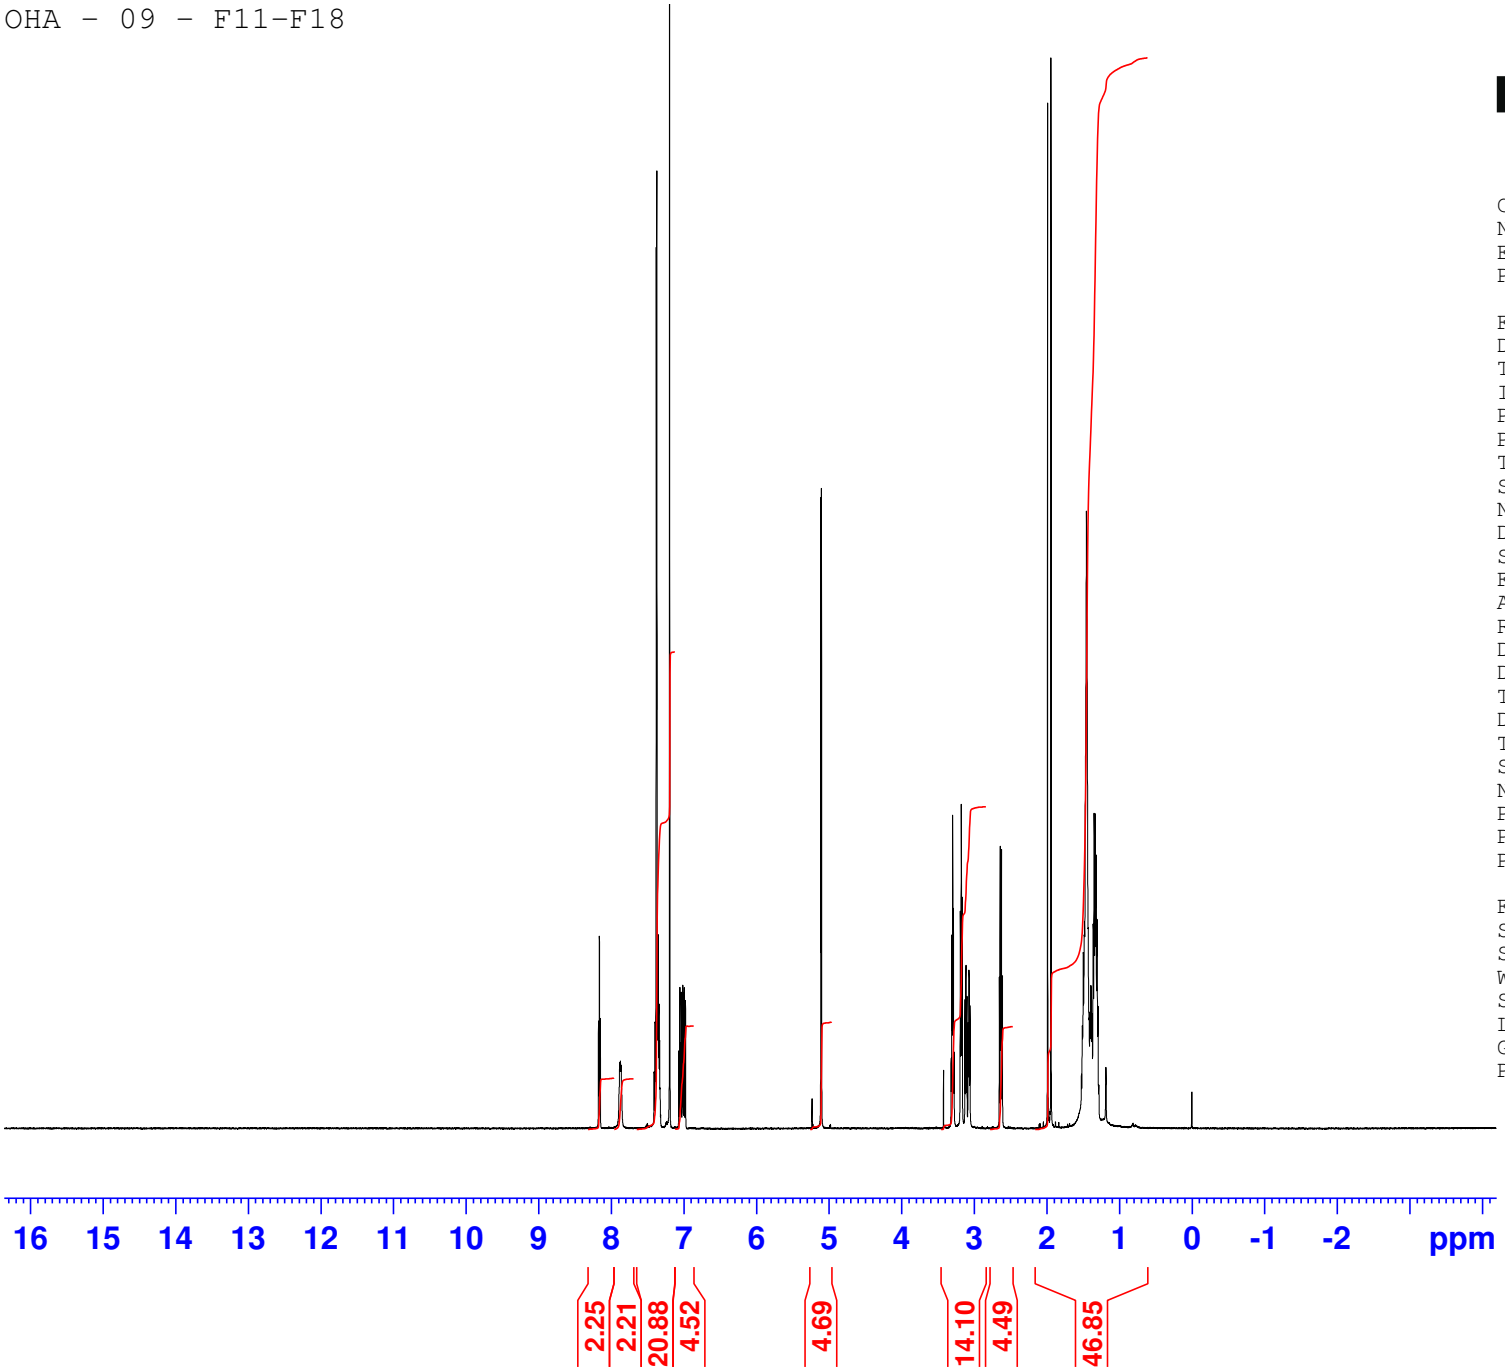

Current Data Parameters
NAME Mertens
EXPNO 900
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20250505
Time 11.29 h
INSTRUM spect
PROBHD Z114607_0045 (
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 64
DS 2
SWH 12335.526 Hz
FIDRES 0.376450 Hz
AQ 2.6563926 sec
RG 144
DW 40.533 usec
DE 6.50 usec
TE 297.9 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1
SFO1 600.1337060 MHz
NUC1 1H
P0 3.74 usec
P1 11.23 usec
PLW1 22.90900040 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 600.1300547 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00