
OHA - 09 - F11-F18

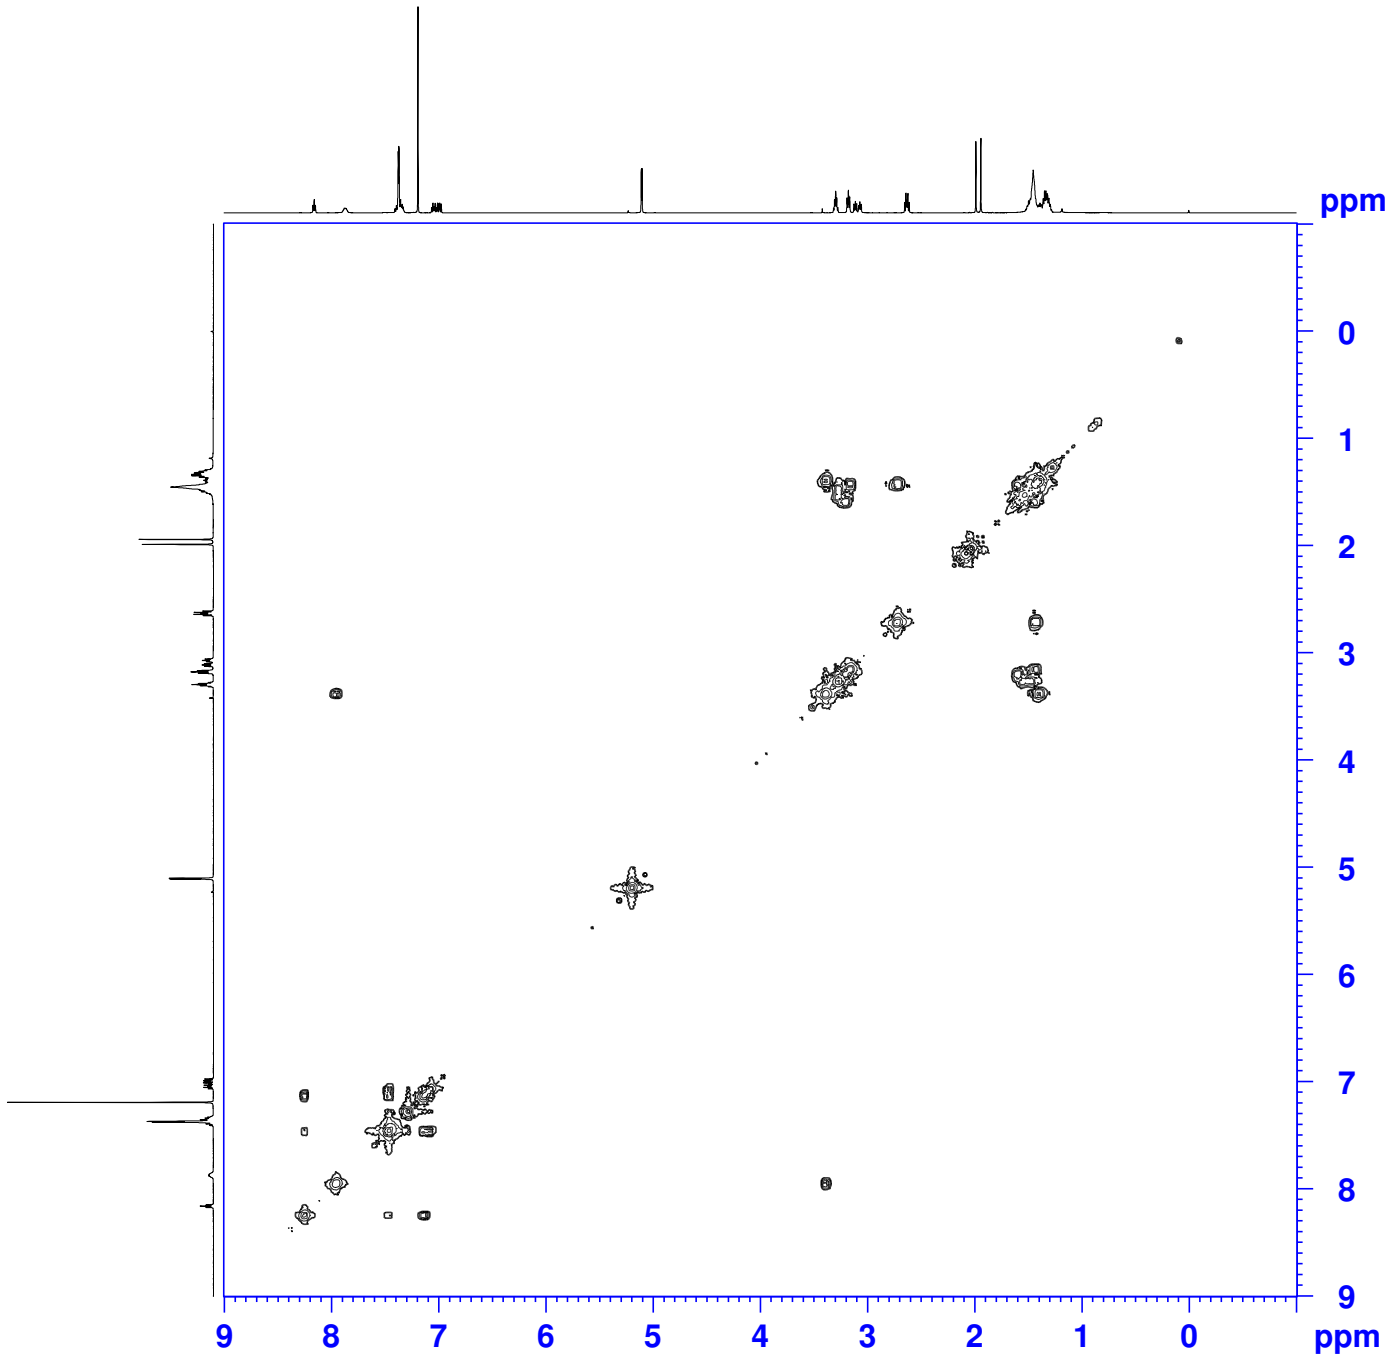

Current Data Parameters
NAME Mertens
EXPNO 904
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20250506
Time 4.36 h
INSTRUM spect
PROBHD Z114607_0045 (
PULPROG cosygpqf
TD 2048
SOLVENT CDCl3
NS 32
DS 8
SWH 6009.615 Hz
FIDRES 5.868765 Hz
AQ 0.1703936 sec
RG 1620
DW 83.200 usec
DE 6.50 usec
TE 300.0 K
D0 0.00000300 sec
D1 1.48689198 sec
D13 0.00000400 sec
D16 0.00020000 sec
IN0 0.00016640 sec
TDav 1
SFO1 600.1324005 MHz
NUC1 1H
P0 11.23 usec
P1 11.23 usec
PLW1 22.90900040 W
GPNAM[1] SINE.100
GPZ1 10.00 %
P16 1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
TD 128
SFO1 600.1324 MHz
FIDRES 93.900238 Hz
SW 10.014 ppm
FnMODE QF

F2 - Processing parameters
SI 1024
SF 600.1300000 MHz
WDW SINE
SSB 0
LB 0 Hz
GB 0
PC 1.40

F1 - Processing parameters
SI 1024
MC2 QF
SF 600.1300000 MHz
WDW SINE
SSB 0
LB 0 Hz
GB 0