
OHA - 09 - F11-F18

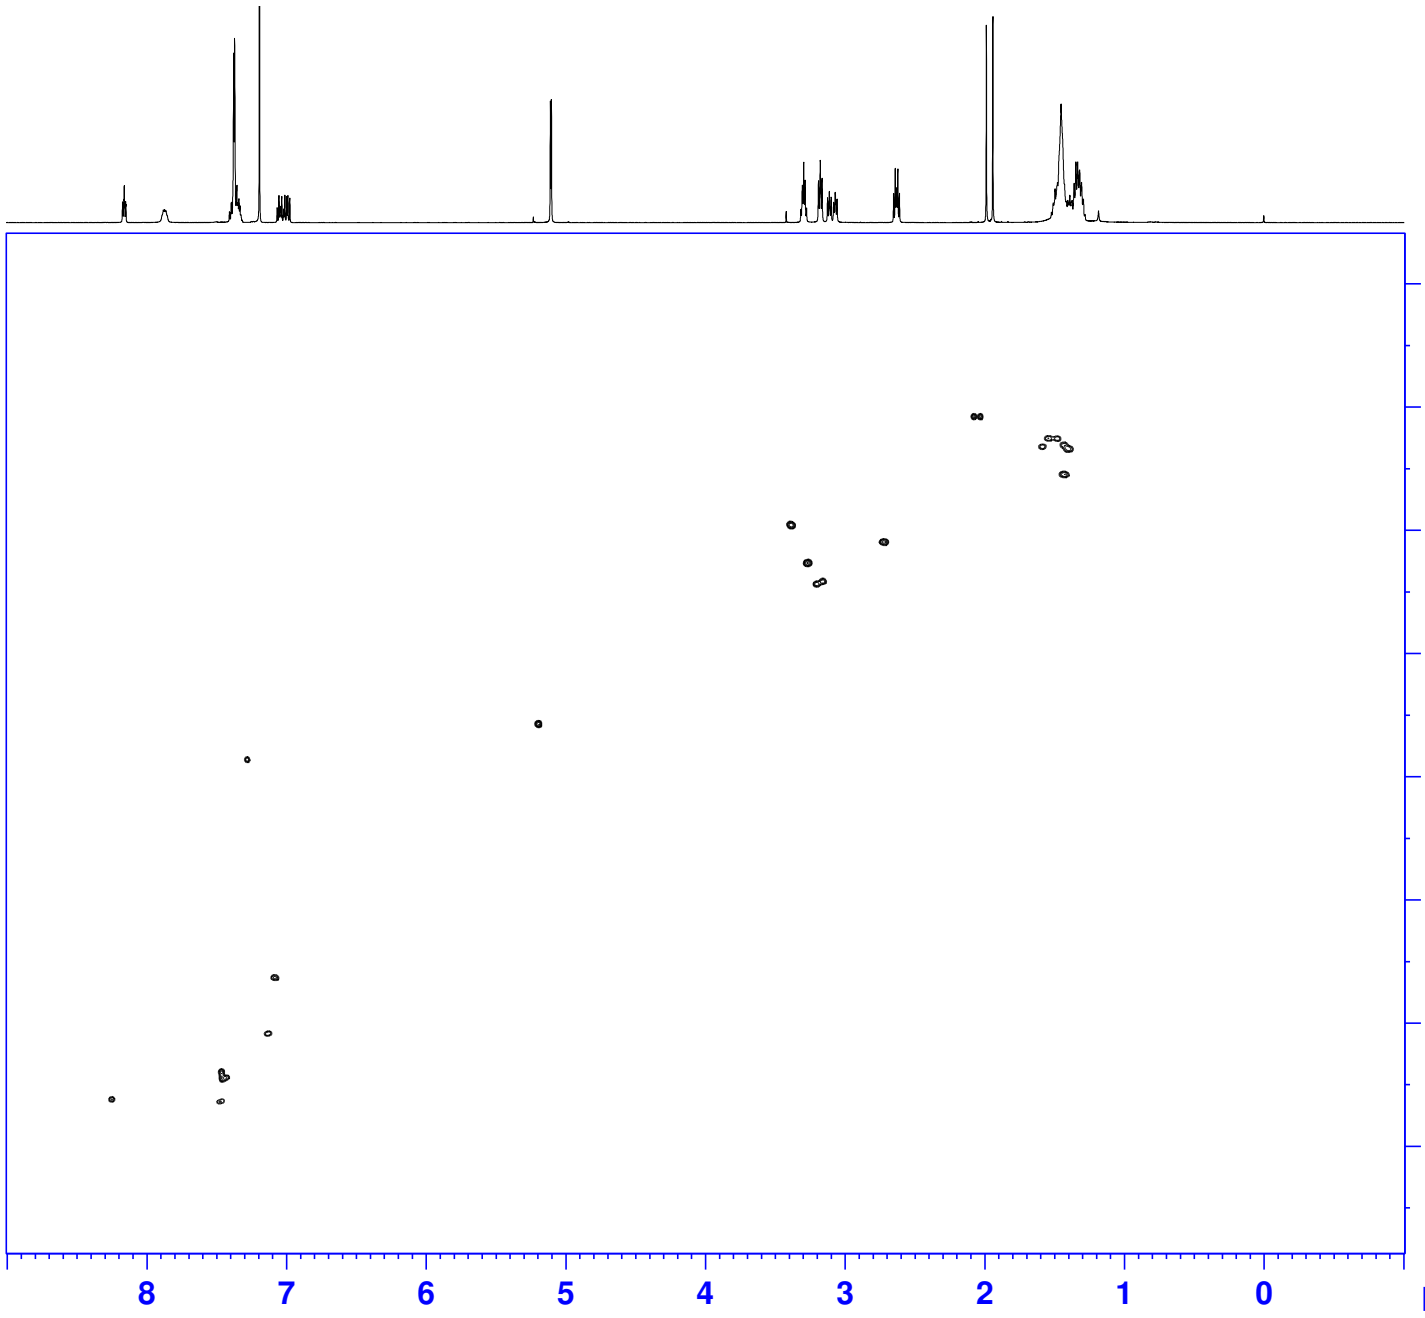

Current Data Parameters
NAME Mertens
EXPNO 902
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20250506
Time 0.29 h
INSTRUM spect
PROBHD Z114607_0045 (
PULPROG hsqcetgp
TD 1024
SOLVENT CDCl3
NS 32
DS 16
SWH 6009.615 Hz
FIDRES 11.737530 Hz
AQ 0.0851968 sec
RG 2050
DW 83.200 usec
DE 6.50 usec
TE 300.0 K
CNST2 145.0000000
D0 0.00000300 sec
D1 1.50000000 sec
D4 0.00172414 sec
D11 0.03000000 sec
D16 0.00020000 sec
IN0 0.00002000 sec
TDav 1
ZGOPTNS
SFO1 600.1324005 MHz
NUC1 1H
P1 11.23 usec
P2 22.46 usec
PLW1 22.90900040 W
SFO2 150.9140628 MHz
NUC2 13C
CPDPRG[2 garp
P3 9.40 usec
P4 18.80 usec
PCPD2 60.00 usec
PLW2 134.89999390 W
PLW12 3.31100011 W
GPNAM[1] SINE.100
GPZ1 80.00 %
GPNAM[2] SINE.100
GPZ2 20.10 %
P16 1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
TD 256
SFO1 150.9141 MHz
FIDRES 195.312500 Hz
SW 165.657 ppm
FnMODE Echo-Antiecho

F2 - Processing parameters
SI 1024
SF 600.1300000 MHz
WDW QSINE
SSB 2
LB 0 Hz
GB 0
PC 1.40

F1 - Processing parameters
SI 1024
MC2 echo-antiecho
SF 150.9028085 MHz
WDW QSINE
SSB 2
LB 0 Hz
GB 0