
OHA - 12 - Main - HC

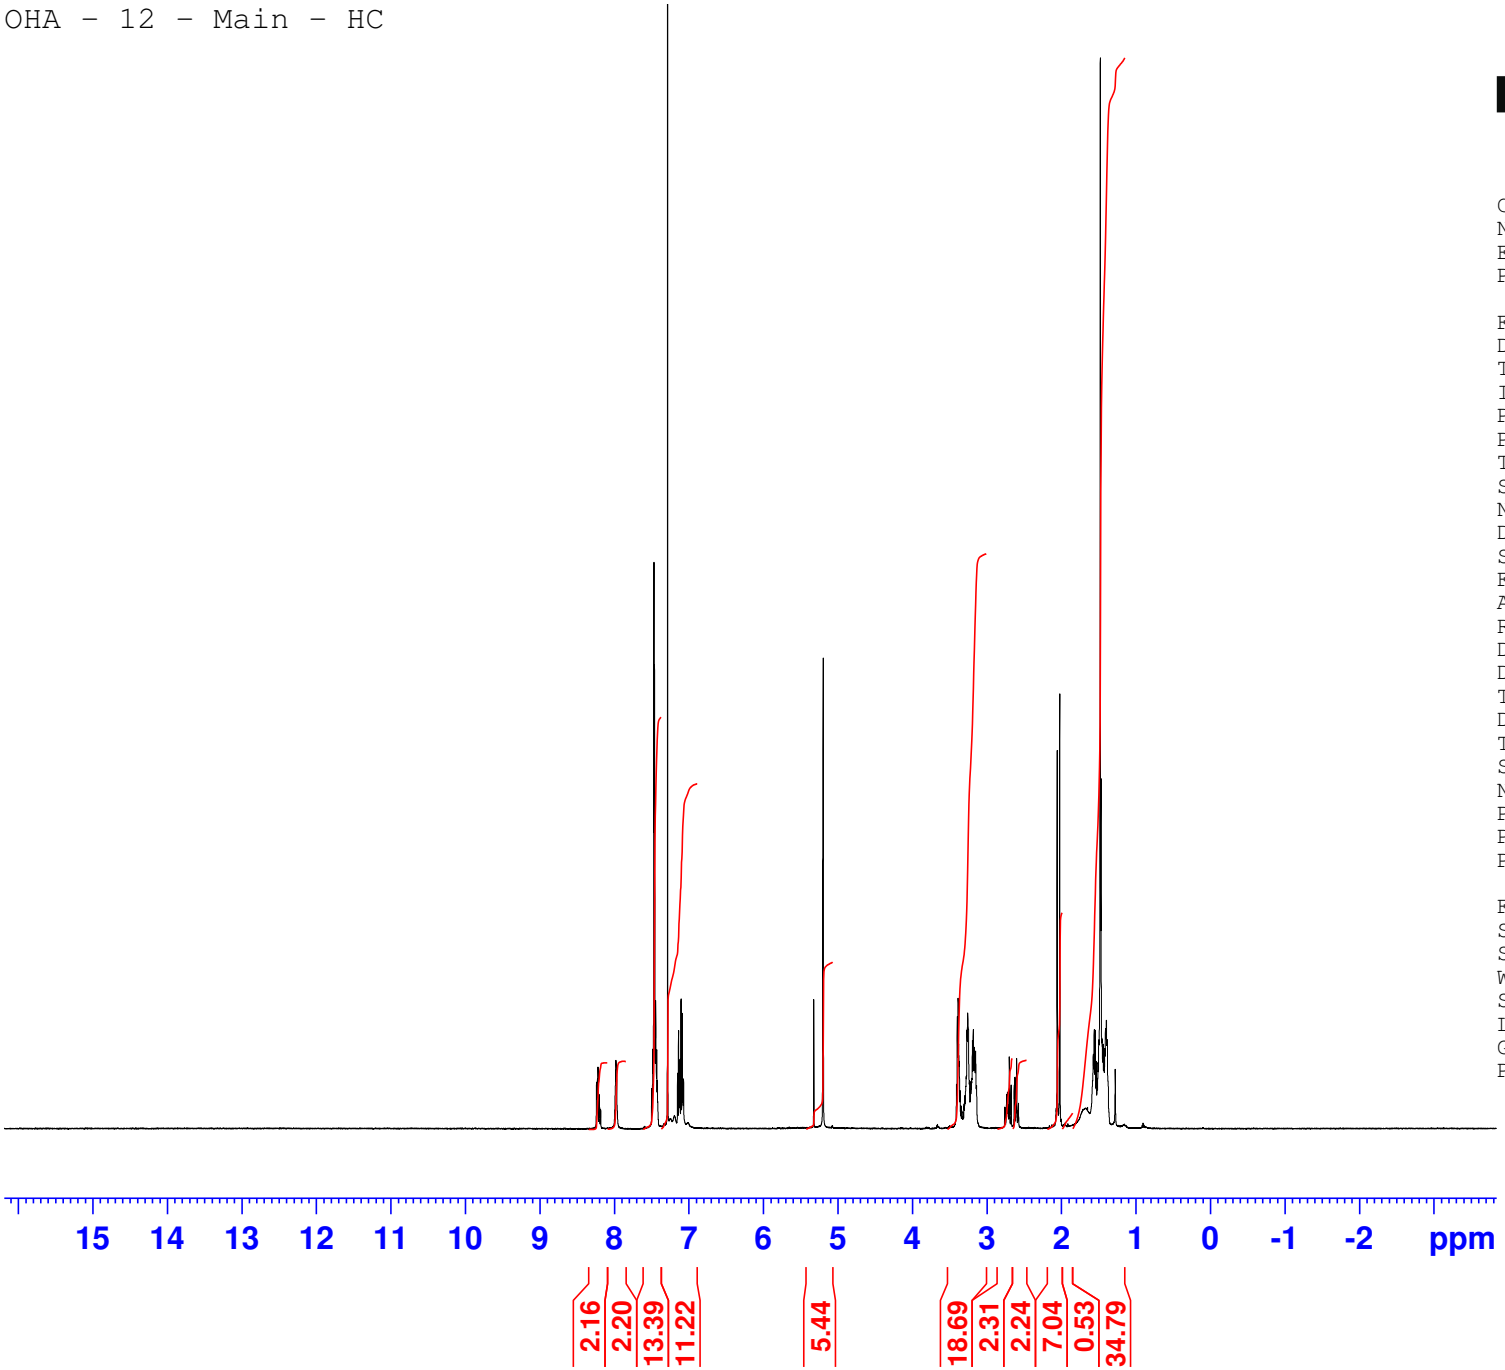

Current Data Parameters

NAME	Mertens
EXPNO	940
PROCNO	1

F2 - Acquisition Parameters

Date_	20250514
Time	1.31 h
INSTRUM	spect
PROBHD	Z114607_0045 (
PULPROG	zg30
TD	65536
SOLVENT	CDCl3
NS	16
DS	2
SWH	12019.230 Hz
FIDRES	0.366798 Hz
AQ	2.7262976 sec
RG	161
DW	41.600 usec
DE	11.06 usec
TE	297.9 K
D1	1.00000000 sec
TD0	1
SFO1	600.1337058 MHz
NUC1	1H
P0	3.74 usec
P1	11.23 usec
PLW1	22.90900040 W

F2 - Processing parameters

SI	65536
SF	600.1300000 MHz
WDW	EM
SSB	0
LB	0.30 Hz
GB	0
PC	1.00