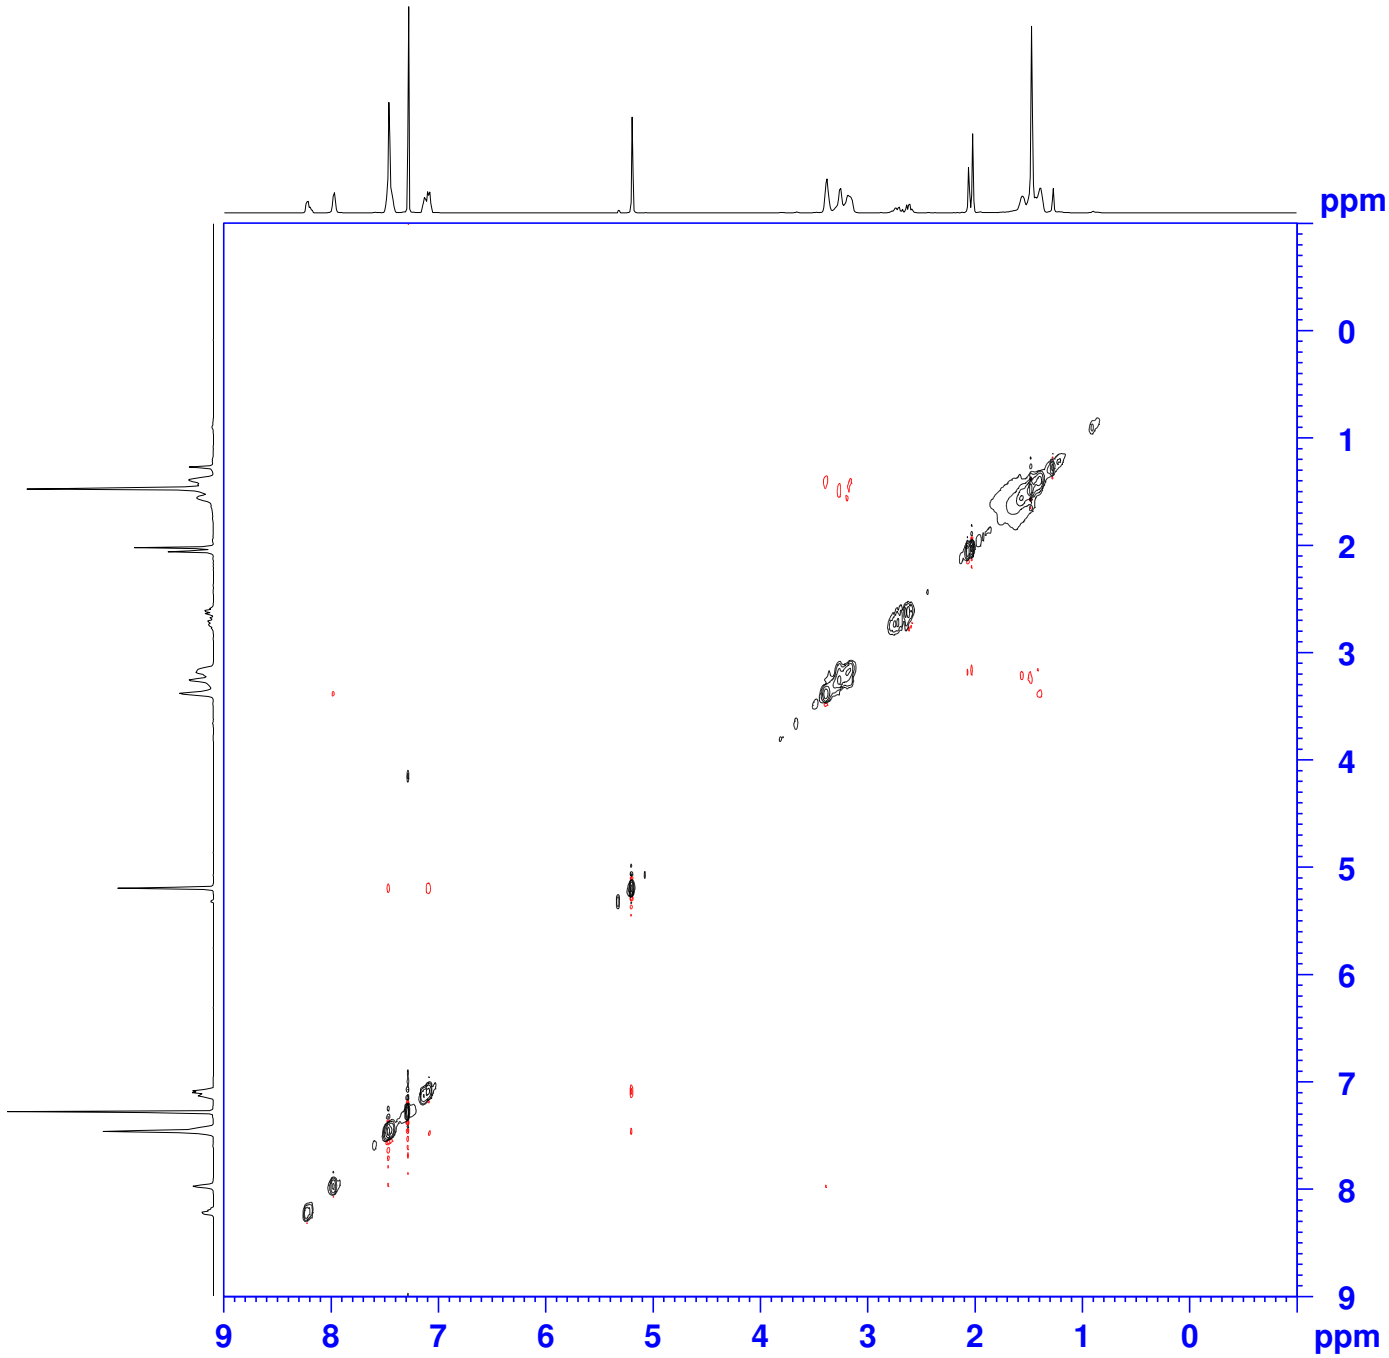


Current Data Parameters

NAME	Mertens
EXPNO	936
PROCNO	1

F2 - Acquisition Parameters

Date_	20250511
Time	7.14 h
INSTRUM	spect
PROBHD	Z114607_0045 (
PULPROG	noesygpphpp
TD	2048
SOLVENT	CDCl3
NS	32
DS	32
SWH	6002.401 Hz
FIDRES	5.861720 Hz
AQ	0.1705984 sec
RG	512
DW	83.300 usec
DE	8.69 usec
TE	297.9 K
D0	0.00006900 sec
D1	2.00000000 sec
D8	0.30000001 sec
D11	0.03000000 sec
D12	0.00002000 sec
D16	0.00020000 sec
IN0	0.00016660 sec
TDav	1
SFO1	600.1324005 MHz
NUC1	1H
P1	11.23 usec
P2	22.46 usec
P17	2500.00 usec
PLW1	22.90900040 W
PLW10	4.62260008 W
GPNAM[1]	SMSQ10.100
GPZ1	40.00 %
P16	1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters

TD	256
SFO1	600.1324 MHz
FIDRES	46.893757 Hz
SW	10.002 ppm
FnMODE	States-TPPI

F2 - Processing parameters

SI	1024
SF	600.1300000 MHz
WDW	QSINE
SSB	2
LB	0 Hz
GB	0
PC	1.00

F1 - Processing parameters

SI	1024
MC2	States-TPPI
SF	600.1300000 MHz
WDW	QSINE
SSB	2
LB	0 Hz
GB	0