
SLH - R53 - comp.

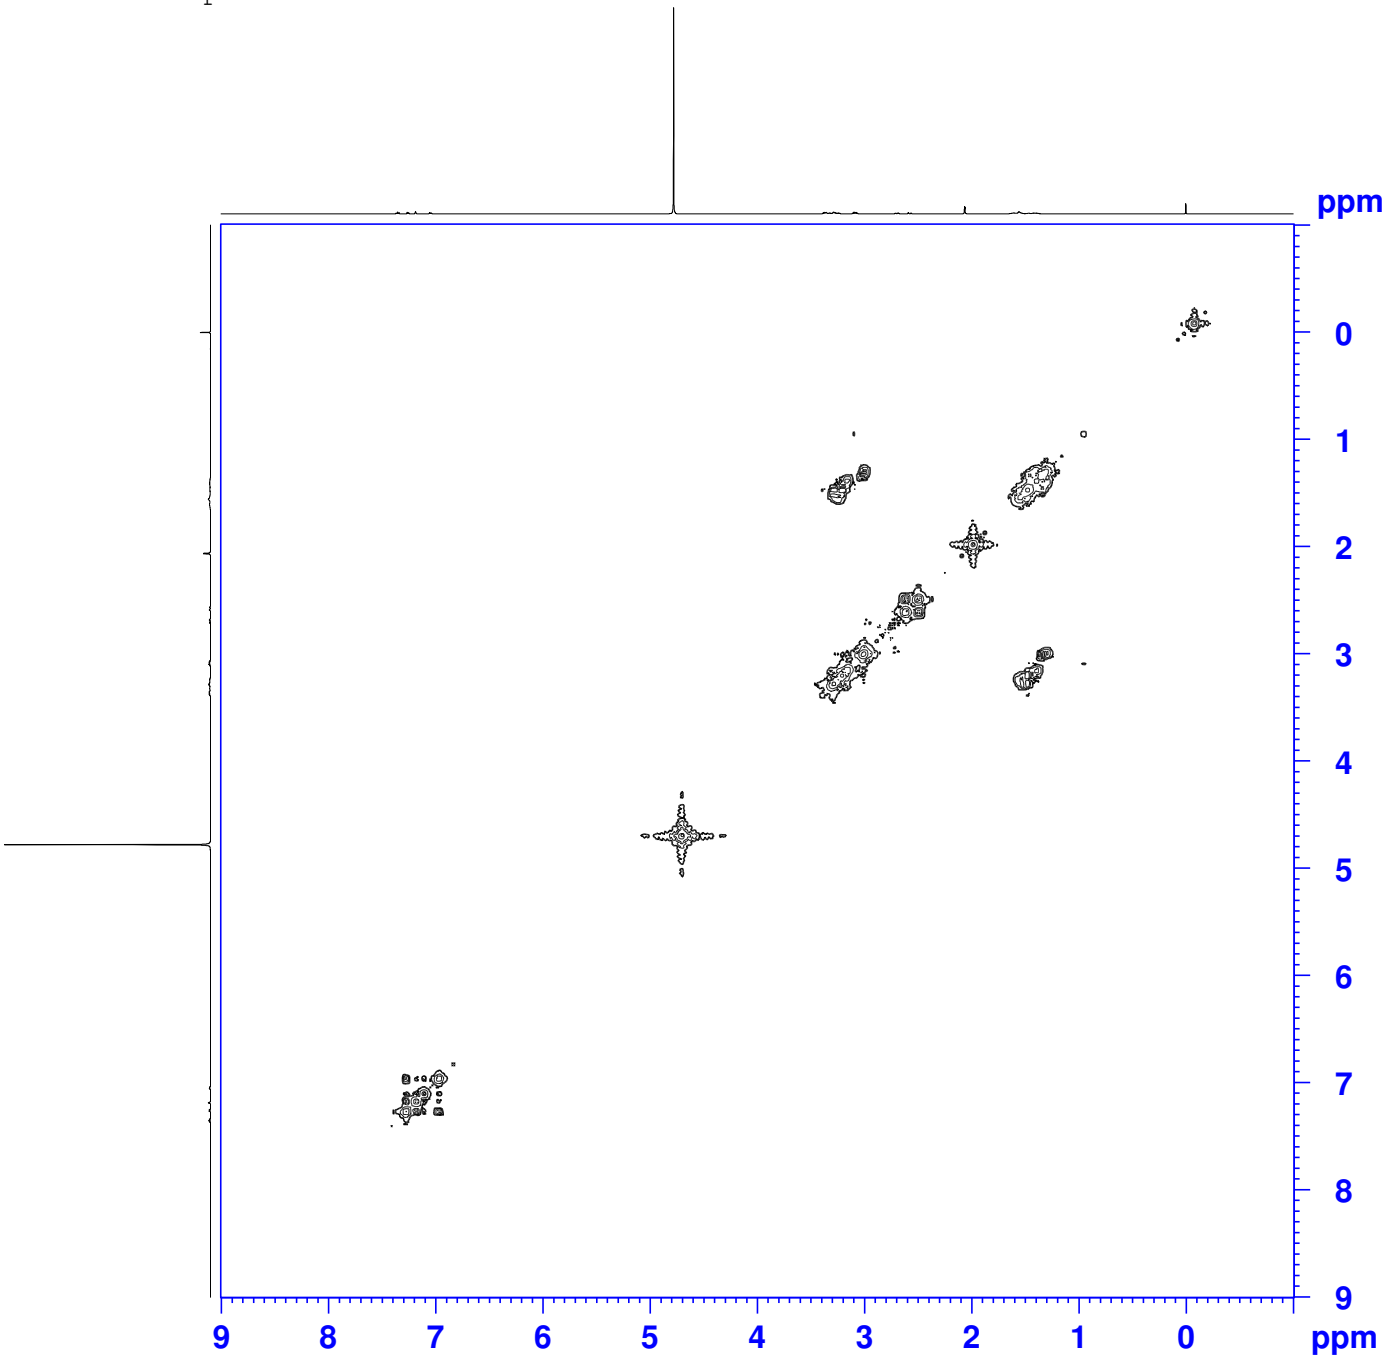

Current Data Parameters

NAME	Huegel
EXPNO	844
PROCNO	1

F2 - Acquisition Parameters

Date_	20250313
Time	7.01 h
INSTRUM	spect
PROBHD	Z114607_0045 (
PULPROG	cosygpqf
TD	2048
SOLVENT	D2O
NS	16
DS	8
SWH	6009.615 Hz
FIDRES	5.868765 Hz
AQ	0.1703936 sec
RG	1440
DW	83.200 usec
DE	6.50 usec
TE	297.9 K
D0	0.00000300 sec
D1	1.48689198 sec
D13	0.00000400 sec
D16	0.00020000 sec
IN0	0.00016640 sec
TDav	1
SFO1	600.1324005 MHz
NUC1	1H
P0	11.23 usec
P1	11.23 usec
PLW1	22.90900040 W
GPNAM[1]	SINE.100
GPZ1	10.00 %
P16	1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters

TD	128
SFO1	600.1324 MHz
FIDRES	93.900238 Hz
SW	10.014 ppm
FnMODE	QF

F2 - Processing parameters

SI	1024
SF	600.1300000 MHz
WDW	SINE
SSB	0
LB	0 Hz
GB	0
PC	1.40

F1 - Processing parameters

SI	1024
MC2	QF
SF	600.1300000 MHz
WDW	SINE
SSB	0
LB	0 Hz
GB	0